

APPAREIL CELLETOX 125A



Vous désirez rester jeunes et profiter pleinement de la vie ?

Malgré le stress et la pollution vous désirez être en bonne santé ?

Est-ce que c'est possible dans notre société industrielle où sous la pression du stress notre corps se charge de plus en plus en toxines et perd la capacité à se nettoyer ?

Intervenir avant que ce ne soit pas trop tard. Une détoxination... Une purification... Changement de mode de vie, une vie saine et naturelle...

Nous pouvons aider le corps à éliminer ces substances nocives sans frustration, sans douleurs, de façon agréable... De façon consciente, ce qui va transformer notre vie, rendre notre corps plus léger et juvénile.

Merci d'avoir choisi notre appareil celldetox

Votre corps va apprécier et aussi vous remercier

C'est un appareil de détoxination ionisante.

Par ce processus les cellules électriquement chargées sont de nouveau bien oxygénées ce qui aide l'auto régénération des cellules.

Comment cela fonctionne-t-il ?

IONISATION

Une molécule d'eau est composée de deux atomes d'hydrogène et d'un atome d'oxygène. Lorsque la molécule perd un atome d'hydrogène la molécule restante OH prend une charge négative. Lorsque vous marchez le long d'une plage, votre corps absorbe des millions d'ions de charge négative lesquels alcalisent le sang et les tissus.

A cause d'une nourriture non équilibrée et d'un stress important, nous avons tendance à accumuler et conserver des quantités excessives d'éléments négatifs nuisibles à notre bien être: lactiques, pyruviques, uriques, carboniques, acétiques, butyriques, acide-hépatiques, di acétiques etc....

UTILISATION

Les praticiens dans le domaine du bien-être et les patients ont tous reconnu beaucoup d'effets positifs suite à des séances de détoxination :

1. PLUS DE SOUPLESSE DANS LES ARTICULATIONS
2. SOULAGEMENT DES DOULEURS DUES A L'ARTHRITE
3. MEILLEUR SOMMEIL
4. UNE AUGMENTATION PALPABLE DE L'ENERGIE
5. UNE VERITABLE SENTATION DE BIEN ETRE

MODE D'EMPLOI

1. Pour commencer:

- Branchez le cordon d'alimentation (face arrière de l'appareil)
- L'électrode (face avant de l'appareil) :
- Le bracelet dans la prise prévue à cet effet sur la face avant de l'appareil (aucun risque d'erreur puisque aucune prise n'est semblable).
- La ceinture IFR (face arrière de l'appareil)
- Ensuite mettez l'électrode dans un récipient rempli d'eau (électrode doit être bien couverte par l'eau),
- Mettez le bracelet, la ceinture IFR,
- Mettez vos pieds dans l'eau et seulement ensuite allumez l'appareil – appuyez sur le l'interrupteur rouge situé à l'arrière.
- Choisissez le mode (bouton « mode ») et la durée (bouton « time » +ou -)
- Pour commencer la procédure appuyez sur « START »

LES CINQ MODES AJUSTABLES AU PH

Pour commencer testez votre PH à l'aide de bandelettes testeur de PH vendues en Pharmacie

Test salivaire et ou urinaire

Ensuite choisissez le mode qui convient d'après le résultat du test

Si vous ne savez pas ou si vous hésitez utilisez le mode N°1 qui lui est adapté à tous.

La lettre A indiquant « ampérage » est seulement une graduation et non l'ampérage réel.

Surveillez donc les premières utilisations afin de ne pas trop ajouter le sel.

Nous vous donnons les seuils de déclenchement de la sécurité à ne pas dépasser

Mode UN : 70% Positif / 30% négatif – maxi A 1,5

Fonction accessible et recommandée pour la majorité des personnes

Rééquilibrer un PH trop acide

Augmente le micro voltage du corps

Mode deux : 30% positif / 70% négatif – maxi A 1,8

Pour rééquilibrer un PH trop alcalin

Augmente le micro voltage du corps

Mode trois : 50% positif / 50% négatif – maxi A 1,8

Maintient l'équilibre du PH

Augmente le micro voltage du corps

Mode quatre : 100% positif – maxi A 2,4

Ions négatifs

Repolarise les cellules

Augmente le PH

Augmente le micro voltage du corps

Mode cinq : 100% négatif – maxi A 2,4

Ions positifs

Détoxine
Diminue le PH
Acidifie le corps
Augmente le micro voltage du corps

Ne pas abuser du mode cinq qui détoxine et acidifie le corps

SURVEILLER REGULIEREMENT SON PH

Ajouter très progressivement du sel jusqu'à ce que l'ampérage se stabilise au degré de détoxination ionisation voulu.

**Nous ne pouvons donner d'instruction précise à ce sujet car cela dépend de la qualité de l'eau utilisée
Trop de sel = augmentation de la conductibilité de l'eau = risque d'alerte par un bip prolongé.
« Arrêtez immédiatement l'appareil » puis changer l'eau et recommencez l'opération.**

Respectez l'ampérage maximum indiqué dans le paragraphe « les cinq modes ajustables au PH »

ATTENTION

1. Soyez prudent et ne touchez pas l'appareil avec des mains mouillées.
2. Ne pas laisser tomber l'appareil
3. N'utilisez pas de produits chimiques pour le nettoyer.
4. Appuyez avec précaution sur les touches pour préserver la longévité de la machine.
L'appareil doit être installé correctement sans risque de tomber dans l'eau.

DEPANNAGE

Dysfonctionnement : Technicien

Sur écran pas d'affichage : Vérifiez le cordon d'alimentation et le fusible

L'électrode ne fonctionne pas : Remettre l'électrode après avoir vérifié l'alimentation

Aucune réponse quand vous appuyez sur les boutons :

Arrêtez l'appareil pendant 10 secondes et redémarrez

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Cet appareil peut être utilisé par des personnes de tout âge. Dans notre famille il est utilisé par des personnes de 16 à 89 ans ! Les séances se passeront bien si les instructions sont suivies soigneusement. Cependant le temps de session et l'intensité varient selon chaque personne.

Le temps de session conseillé pour un adulte est entre 30 mn et 60 mn

Temps de session conseillé pour un enfant de 8-10 ans – pas plus que 15 min sous la surveillance d'un adulte.
Nombre de séance entre 6 et 10.

Pour les personnes âgées de moins de 50 ans nous recommandons une cure de 14 séances (une tous les 2 jours). Ensuite arrêter pendant 3 semaines avant de recommencer un traitement de 14 séances.

Les personnes âgées de plus de 50 ans peuvent utiliser l'appareil tous les 3 jours pour une cure de 14 séances. Puis arrêter et faire une séance par semaine jusqu'au printemps ou l'automne ou vous pouvez faire de nouveau un traitement foncier

La fréquence des séances est aussi fonction de chacun de son hygiène de vie et de son environnement et de son vécu dans la pollution

Mais toujours respecter cette règle :

Ne pas utiliser trois jours de suite.

Ne pas utiliser deux fois par jour.

Après le traitement foncier d'une quinzaine de séances, suite à notre expérience, nous vous recommandons de faire une séance par semaine pour laisser au corps le temps de bien assimiler les changements dans les cellules, dans les organes et aussi pour une meilleure adaptation sur un plan psychique et émotionnel. Comme chacun est différent, observez bien les changements qui vont survenir lors des séances et les jours qui suivent pour adapter le rythme des sessions suivant ces données.

Il est possible, si on a un rythme de vie très stressant, de ressentir une détente, voir une fatigue après les premières séances. C'est un bon signe. Ne vous inquiétez pas si vous ressentez des perturbations émotionnelles. Cela indique que les toxines émotionnelles s'évacuent avec les toxines chimiques

Utilisez de l'eau ordinaire surtout pas distillée ou adoucie

Toutes les qualités d'eau sont différentes. Il est nécessaire de bien s'habituer aux caractéristiques des eaux locales.

Les capacités conductrices sont liées à la qualité de l'eau et déterminent l'effet des ions et influencent la détoxination.

Ajoutez seulement une pincée de sel de temps en temps pour ajuster la conductivité de l'eau.

Ajouter du sel augmente la conductibilité de l'eau donc de la détoxination,

Mais pour préserver la vie de l'électrode et de l'appareil, évitez d'ajouter trop de sel.

Avec l'expérience on arrive à bien régler les données.

L'électrode a besoin d'être nettoyée après chaque utilisation. Laissez-la tremper pendant 10-20 min dans une solution de vinaigre blanc et de l'eau, bien la sécher.

Le temps de session conseillé pour un adulte varie selon le mode choisi. Vous pouvez le modifier en appuyant sur les touches « + » ou « - ».

CONTRE-INDICATIONS

Il n'est pas recommandé d'utiliser l'appareil de détoxination pour certaines personnes :

Les personnes qui portent un stimulateur cardiaque (pacemaker);

Les personnes qui ont reçu une transplantation d'organe;

Les femmes enceintes ou qui allaitent;

Les personnes qui ont des blessures ouvertes sur les pieds;

Les personnes qui souffrent d'épilepsie;

Les personnes qui prennent des médicaments indispensables au maintien de la vie.

LA CEINTURE DE BAMBOU INFRAROUGE,

NE PAS METTRE DIRECTEMENT SUR LA PEAU

Elle est attachée à notre taille et fait également partie des accessoires de l'appareil. Elle chauffe en émettant des infrarouges, stimulant ainsi les organes de sécrétion (foie, pancréas, rate).

L'évacuation des substances toxiques est adéquate et non violente sous l'influence de l'augmentation du niveau ionique dans le corps ; c'est pour cette raison, qu'il n'y a pas de contre-indication.

L'appareil stimule exclusivement les fonctions de sécrétion naturelle du corps, il stimule l'évacuation des poisons et d'autres résidus.

Le traitement ne permet pas à notre organisme d'éliminer les substances importantes telles les vitamines, les minéraux, la nourriture ou les médicaments absorbés non assimilés.

Il ne faut donc pas avoir peur que ce traitement nous supprime les vitamines et les minéraux indispensables à l'existence, il peut être, en outre, appliqué dans toute thérapie.

BIENFAITS DES INFRAROUGES

- Sensation de notre bien-être général
 - Stimule la micro circulation
 - Augmente le transport de l'oxygène et de la nourriture dans les cellules sanguines au tissu de l'organisme ;
 - Aide au fonctionnement des globules blancs ; de ce fait, elle stimule les réactions de l'immunité et l'évacuation des pathogènes et des résidus cellulaires
 - La thérapie infrarouge s'inscrit aux méthodes des thérapies lumières, elle diminue sensiblement la douleur dans notre organisme sans effets secondaires
- Stimule la circulation sanguine
- Neutralise les effets des champs magnétiques nuisibles ;
 - Le celldetox- un outil de confort d'équilibre et de bien-être, qui peut vous aider de manière complémentaire pour corriger certains troubles

BENEFICES POTENTIELS DU « CELLDETOX »

- Élimination des déchets du corps pouvant être une cause de problèmes de ralentissement du métabolisme
- Peut aider à faire disparaître des problèmes de peau.
- Désactivation des virus, bactéries, levures et champignons (se développent avec difficulté dans une solution ionique)
- Effets bénéfiques sur la perte de poids
- Soulagement des maux de tête
- Amélioration de l'échange cellulaire
- Élimination des métaux lourds (non assimilables), que l'on retrouve dans l'analyse des boues résultant du bain
- Augmentation de la vitalité générale de notre corps
- Aide à soulager les douleurs, les tensions
- Meilleure qualité de sommeil
- Réduction des inflammations et de la rétention d'eau
- Sans contre indication pour les enfants de huit ans et plus

Bienfaits de la thérapie magnétique pulsée pour la santé

ATTENTION UTILISER les CHAMPS ELECTROMAGNETIQUES PULSES DE L'APPAREIL HORS DES SEANCES DE DETOXINATION-IONISATION

- Améliore la régénération et accélère la récupération après un effort physique, des séances d'entraînement intenses, etc.
- Les CEMP équilibrent les méridiens d'acupuncture du corps.
- Renforce le système immunitaire - l'intensité magnétique douce ne sur stimule pas le corps
- Améliore la guérison des plaies, la blessure postopératoire guérissant, améliorent la guérison de cicatrice, les dommages, etc.
- Effets positifs sur la réduction de douleur résultant des diverses causes - arthrite, douleur dorsale, bursites, effort musculaire, etc.
- La thérapie magnétique pulsée normalise le potentiel électrique cellulaire ce qui favorise un métabolisme plus sain

Pour le Système Cardiovasculaire:

- Renforce le système cardiovasculaire
- Améliore la circulation sanguine et la microcirculation - réduit l'adhérence des plaquettes (viscosité)
- Influence positive sur les désordres secondaires, tels que la migraine, l'acouphène.
- Empêche la thrombose (caillots de sang)
- Règle la haute et la basse tension artérielle - stimule la production naturelle d'oxyde nitrique qui détend les vaisseaux sanguins et augmente leur diamètre.
- Améliore les valeurs du sang : améliore le niveau de cholestérol, augmente la pression partielle de l'oxygène

Système Respiratoire

- Augmente l'assimilation de l'oxygène, réduit les problèmes respiratoires et les crises d'asthme

Système Squelettique

- A. Accélère la guérison des os - augmente le niveau de calcium et de magnésium dans les cellules et les os
- B. Ostéoporose - augmentation mesurable de la densité osseuse (20 à 30 pourcents) après seulement six mois d'usage quotidien
- C. Arthrite - réduit la douleur et l'inflammation, améliore la circulation et l'oxygénation

Guérison des Muscles et Tissus

- A. Favorise la guérison des blessures musculaires, des elongations, entorses, tendinites, bursites
- B. A des effets positifs pour la Fibromyalgie - pas une cure, mais soulage les symptômes avec un usage continu
- C. Accélère la guérison postopératoire des tissus, cicatrices, etc.

Métabolisme et Système Hormonal

- A. Améliore les fonctions métaboliques
 - B. Stimule la production d'ATP qui procure plus d'énergie aux cellules
 - C. Évacue plus facilement les déchets et toxines hors des cellules
 - D. Effets positifs: diabète, désordres rhumatismaux, allergies, plaintes ménopausale


B. Système Nerveux

- A. Réduit le stress
- B. Effets positifs sur la nervosité, syndrome de l'épuisement, désordres du sommeil

Tranches ou patchs champs électromagnétiques pulsés

Ci-dessous les différents endroits où placer les patchs

Pour traiter une douleur mettez les patchs de chaque côté de l'endroit à traiter pendant une durée de 20 mn 2 à 3 fois par jour si nécessaire

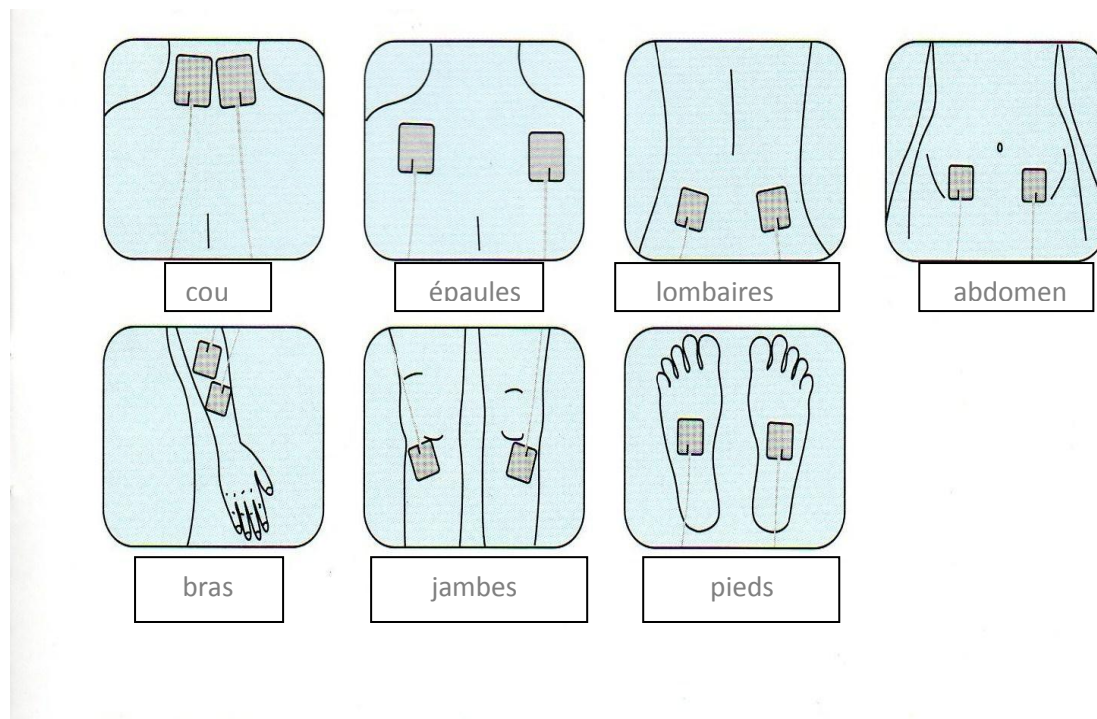

CONTENU :

- 1 Unité de base
- 1 câble d'alimentation
- 1 mode d'emploi
- 2 bobines/électrodes (cathode)
- 1 bracelet (anode)

- 1 ceinture thérapeutique infrarouge bambou
- 1 tube de gel de contact
- 1 paire de patchs pour stimulation CEMP